




อย่าหลงเชื่อ




อุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต อ่างรักษาสารพัดโรค



อัมพฤกษ์ อัมพาต

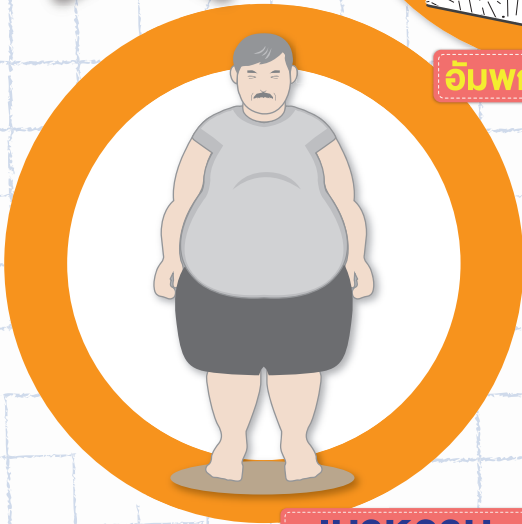

เบาหวาน

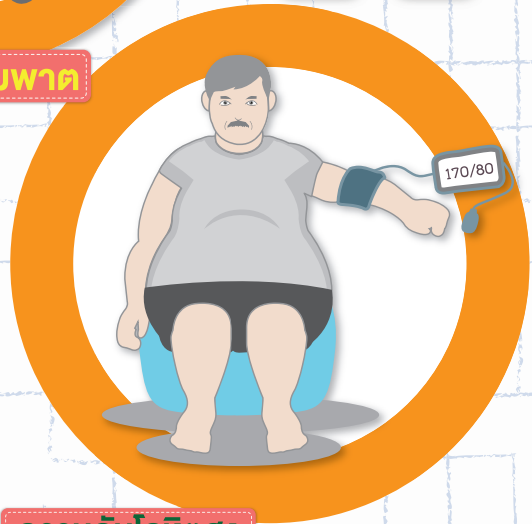

ความดันโลหิตสูง

ข้อเท็จจริง : อย. ไม่เคยอนุญาต อุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตที่มีข้อบ่งใช้หรือ วัตถุประสงค์การใช้ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต